

Zeitschrift: Mitteilungen aus dem Gebiete der Lebensmitteluntersuchung und Hygiene = Travaux de chimie alimentaire et d'hygiène

Herausgeber: Bundesamt für Gesundheit

Band: 68 (1977)

Heft: 1

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)


Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 07.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

BÜCHI Stickstoffbestimmungs-System

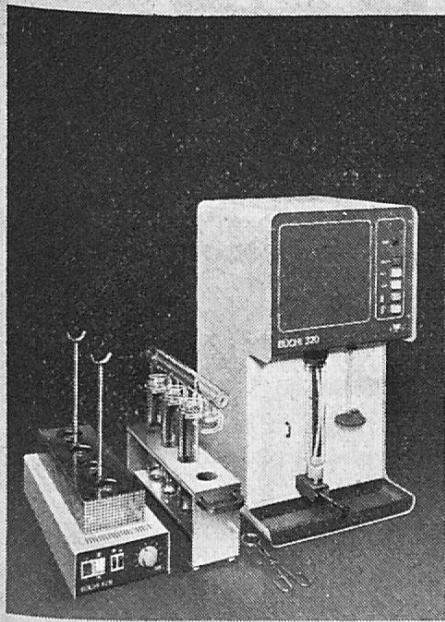

Bitte verlangen Sie ausführliche Unterlagen

BÜCHI

Aufschlussapparat BÜCHI 425


- 4 Infrarot-Aufschluss-Stellen
- Eingebauter Leistungsregler
- Keine Geruchsbelästigung dank wirkungsvoller Absaugvorrichtung
- Gleiches Glasgefäß für Aufschluss und Destillation

Destillationseinheit BÜCHI 320

- Eingebaute Vorratsbehälter für H₂O und NaOH, Zudosierung in beliebigen Mengen
- Kein Umfüllen der Proben
- Hohe Betriebssicherheit
- Destillationsrückstand wird abgesaugt
- Einfache Bedienung und Wartung

1076dA17

BÜCHI LABORATORIUMS-TECHNIK AG, CH-9230 FLAWIL/SCHWEIZ

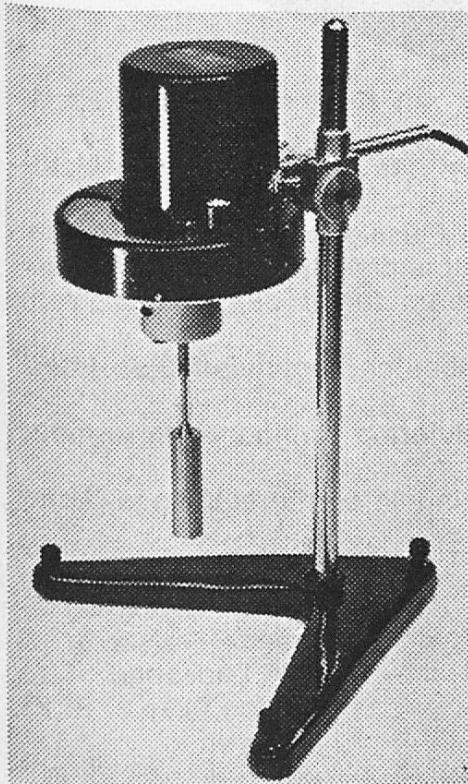

lösen Ihre Viskositätsprobleme in
Labor und Betrieb!

Brookfield-Viskosimeter

RUDOLF HUNTER
Rotfluhstr. 19, Tel. 01 - 65 42 72
8702 ZOLLIKON-ZÜRICH

Dissertationen
Zeitschriften
Bücher


Ehrli Druck AG Buchdruckerei
Sarnen Telefon (041) 66 10 33

ANKÜNDIGUNG

Nr. 16

Fluoreszenz-Detektor LC 1000

Das neue Spektrofluorimeter für die Flüssigchromatographie!

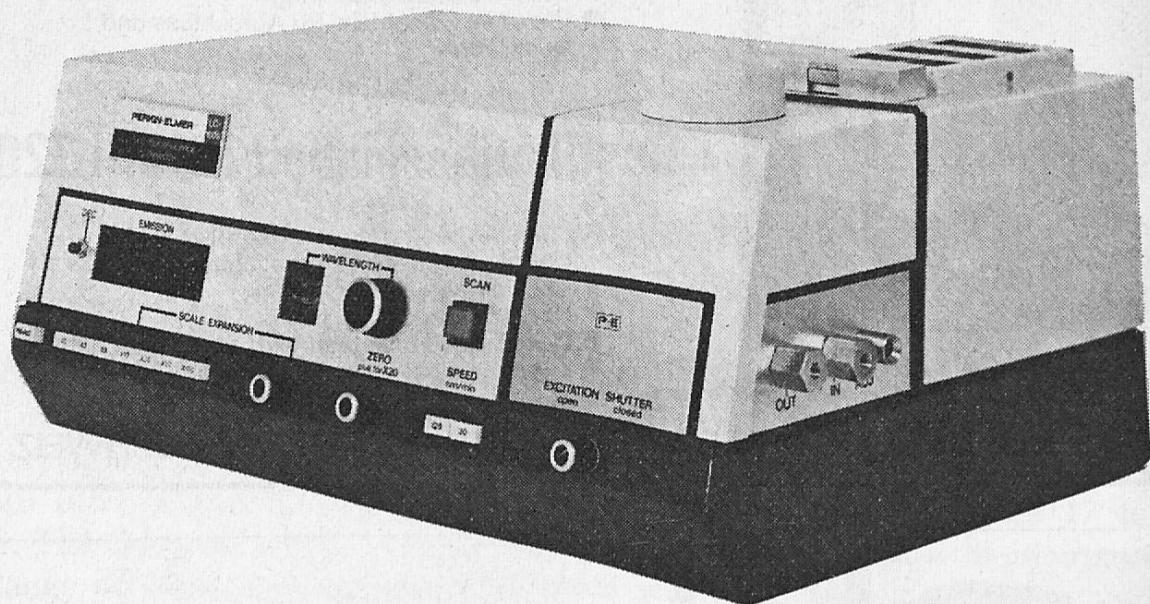

- Verhältnis messendes Filterspektrofluorimeter mit Referenzdetektor, Emissionsmonochromator und Digitalanzeige.
- Gepulste Xenon-Kontinuum-Lichtquelle, erübrigt das Austauschen von Lichtquellen.
- Quarz-Mikrodurchflußküvette, optimiert für die Flüssigkeitschromatographie.
- Die Anregungswellenlänge wird durch schmalbandige Interferenzfilter ausgewählt und kann durch Schwenken des Filters leicht dem Meßproblem angepaßt werden.
- Die Emissionswellenlänge wird mit dem eingebauten kontinuierlichen Interferenzfilter eingestellt.
- Die Aufnahme des Emissionsspektrums von eluierten Komponenten ermöglicht deren Identifikation.
- Umschaltbare Dehnungsfaktoren, Schreiber- und Integratorausgänge, kompakte Bauart.

Perkin-Elmer AG
Fähnlibrunnenstraße 15
8700 Küsnacht
Telefon 01 - 90 53 61
Telex 53 970

Büro Basel
Münchensteinerstraße 87
4052 Basel
Telefon 061 - 34 42 95

Bureau Lausanne
Avenue Fraisse 3
1006 Lausanne
Telefon 021 - 27 81 21

PERKIN-ELMER
IM SCHRITT MIT DER ZEIT