

Zeitschrift: Mitteilungen aus dem Gebiete der Lebensmitteluntersuchung und Hygiene = Travaux de chimie alimentaire et d'hygiène
Herausgeber: Bundesamt für Gesundheit
Band: 80 (1989)
Heft: 4

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 28.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Automatisierte und handbediente

**TOBLER-
WASSERFILTER
TOBLER-
DOSIERAUTOMATEN**

zur Aufbereitung von
Trink- und Industrierwasser


Jacques Tobler AG, 6010 Kriens
Telefon 041 - 41 76 77

Leitung:
K. Tobler, dipl. Ing. chem.. ETH

**WARING-
Labormischer**

1 Liter – 2 Liter – 4 Liter
Minibecher von 12–250 ml

**Vielseitiges
Zubehör
schon
ab 765.—**

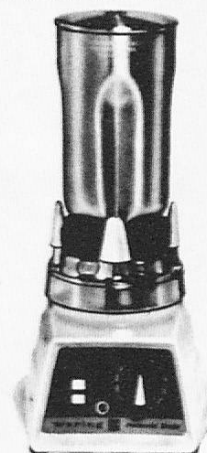


**Verlangen Sie Prospekt oder
Probelieferung**





Dr. Bender & Dr. Hobein AG
8042 Zürich, Tel. 01 361 17 77

tecator -Fibertec für das Nahrungs- mittel-Labor

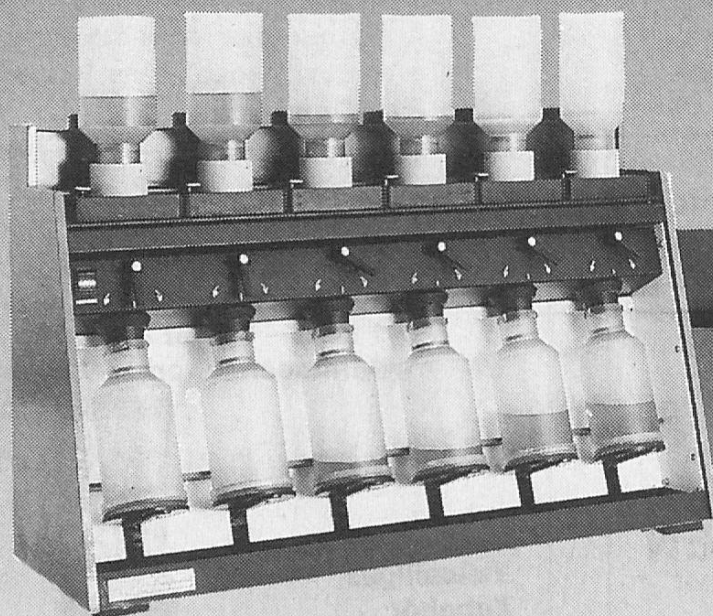


- Die ideale Lösung für die schnelle und exakte Nahrungsfaser-Analyse
- Bis zu 24 Bestimmungen pro Tag.

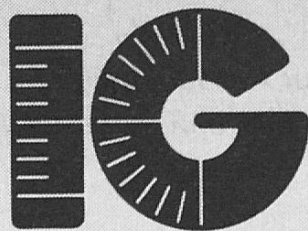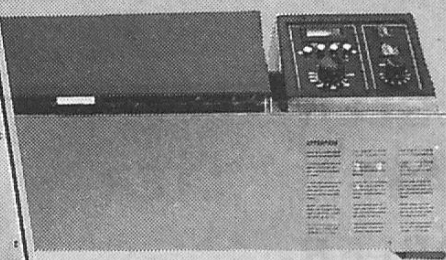

IG Instrumenten-Gesellschaft AG
Räffelstrasse 32
8045 Zürich
Telefon 01/461 33 11

DIE PERFEKTION AN LAUFRUHE.

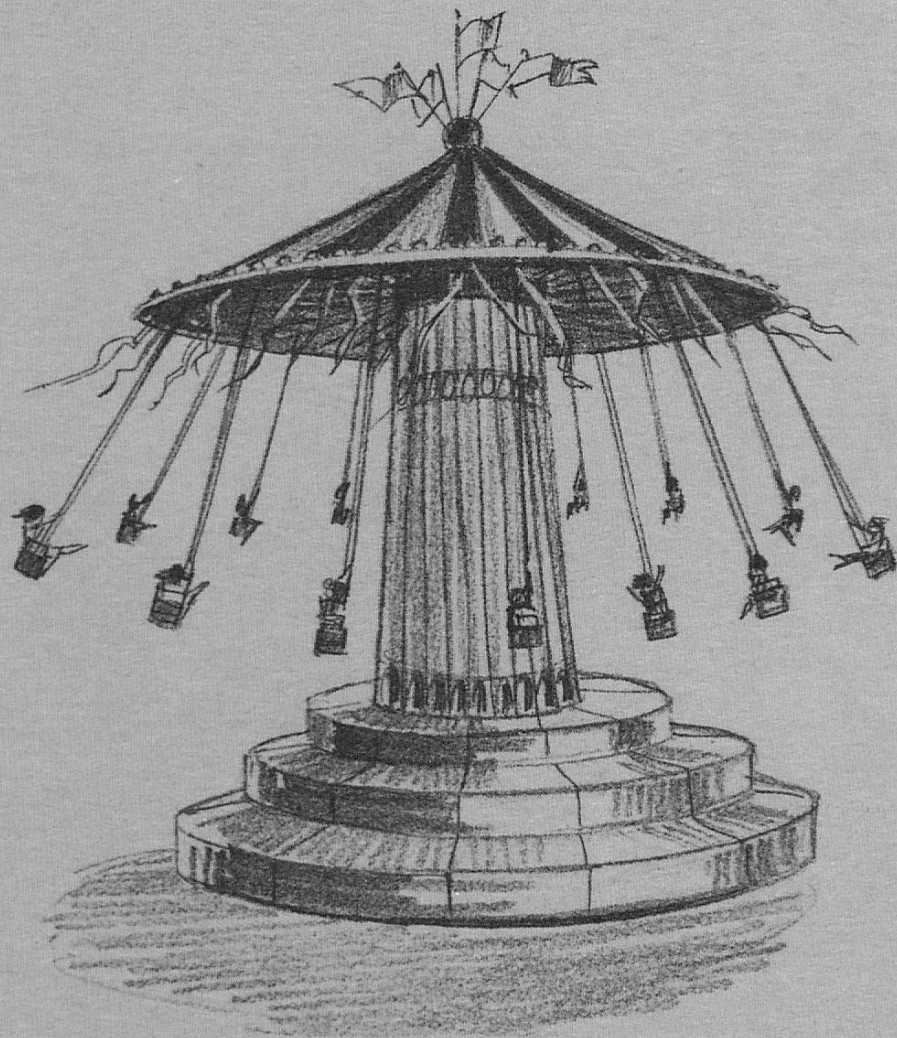


Zentrifugen müssen auch in den höchsten Drehzahlbereichen absolut laufruhig ihre Runden drehen. Darum finden Sie bei uns das moderne SIGMA-Zentrifugen-Programm. Das bedienungsfreundliche und zuverlässige Geräte für prak-

tisch alle Anwendungen umfasst: Mikrozentrifugen, grossvolumige Tischzentrifugen und leistungsfähige Standmodelle. Das ABS-Verkaufsprogramm orientiert sich an den Grundsätzen von Qualität und Wirtschaftlichkeit. Es wird ergänzt durch grosszügige Serviceleistungen, prompte Lieferbereitschaft und anwendungsbezogene Kundenberatung.

8953 **Dietikon** Postfach, Rüchligstrasse 20,
Telefon 01 741 14 44, Telex 825 254,
Telefax 01 740 66 42.

4002 **Basel** Postfach, Münchensteinerstr. 87,
Telefon 061 331 50 80, Telex 963 073,
Telefax 061 331 57 45.

1227 **Carouge-Genève**, 16, rue des Moraines,
Tél. 022 42 32 00, Téléfax 022 42 80 75.




ABS AUER BITTMANN SOULIÉ AG

ABS 
Bringt Qualität ins Labor

Dank automatischer Bürettenansteuerung automatisiert und vereinfacht der neue **METTLER Titrator DL70 Ihre Titrationsen — ohne mehr Platz zu brauchen.**

Interessiert? Dann rufen Sie uns am besten
gleich an.

Mettler Instrumente (Schweiz) AG
Grabenstrasse, 8606 Nänikon-Uster
Tel. (01) 941 61 61, Telefax (01) 941 60 16
Telex 828844

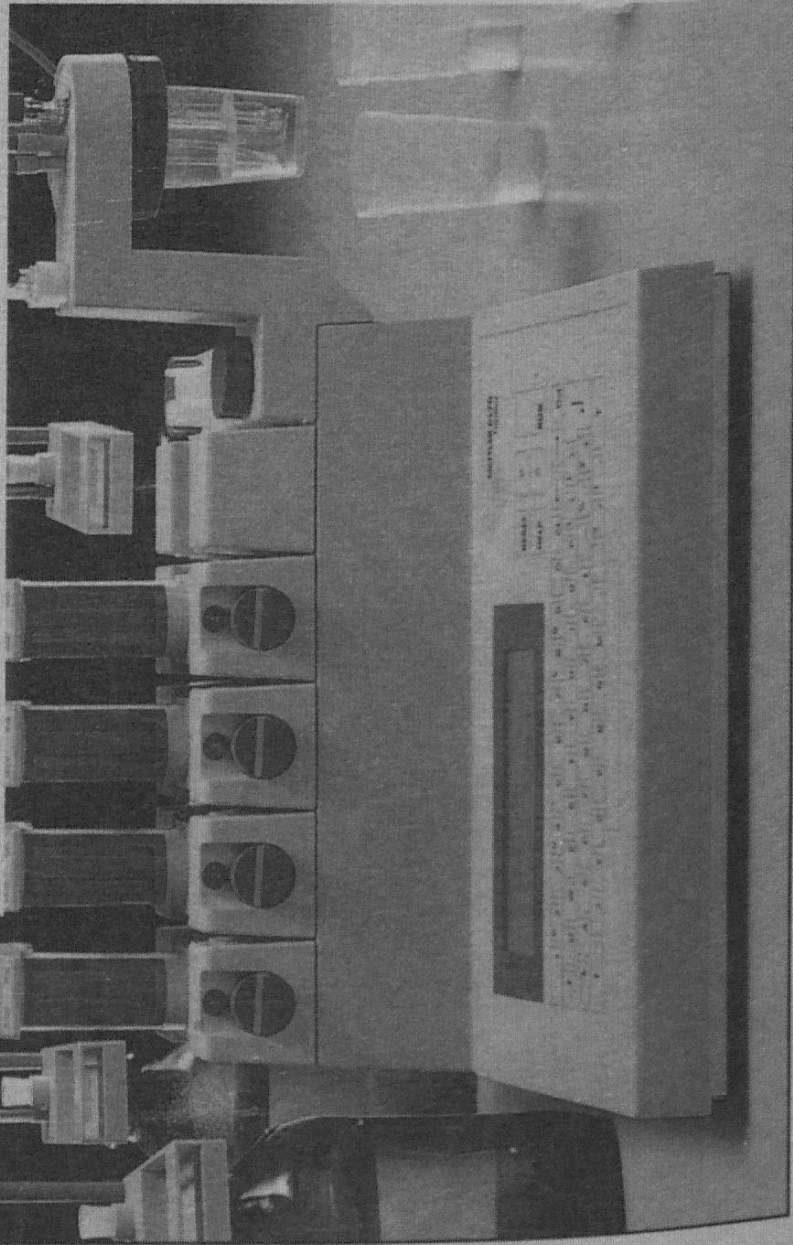

METTLER

6804.71