

**Zeitschrift:** Physiotherapie = Fisioterapia  
**Herausgeber:** Schweizerischer Physiotherapeuten-Verband  
**Band:** 37 (2001)  
**Heft:** 5

## **Inhaltsverzeichnis**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**



L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 03.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

INHALT		SOMMAIRE		SOMMARIO	
Editorial		Editorial		Editoriale	
Ein Entscheid für die Zukunft		Une décision pour le futur		Una decisione per il futuro	
3					
Praxis		Pratique		Pratica	
					
Der Straight-Leg-Raise-Test (SLR) wird in der Physiotherapie differentialdiagnostisch eingesetzt. Dabei interessiert in jüngerer Zeit besonders die Frage, ob dabei neurale Strukturen die SLR-Bewegung qualitativ und quantitativ modifizieren. Die Untersuchung behandelt die Frage, ob in einer präzise erfassten Drehmoment-Winkelkurve die quantitativen Veränderungen von Hüftflexionswinkel und Drehmoment zur Kennzeichnung des Dehnwiderstandes sowie der elektrischen Aktivierung der Muskulatur sichtbar werden, wenn der SLR ohne und mit verschiedenen Zusatzbewegungen ausgeführt wird.		Matthias Fenzl et al. <b>Rückenschwimmen bei Wirbelsäulenbeschwerden</b>		4	
17		Niko Seichert et al. <b>Die physiotherapeutische Entscheidungsanalyse, Teil 1: Validierung der Befundung und Behandlung in der Physiotherapie mit Hilfe von «Evidence Based»-Kriterien</b>		8	
		Barbara Cottier et al. <b>Der Straight-Leg-Raise-Test</b>		17	
		Khelaf Kerkour et al. <b>Evaluation d'un programme de rééducation intensive après hernie discale lombaire opérée</b>		27	
Verband		Fédération		Federazione	
Aktivitäten		Activités		Attività	
– Der SPV gibt sich ein neues Erscheinungsbild und einen neuen Namen ✓		– Nouvelle image et nouveau nom pour la FSP		– La FSF si dà un nuovo nome e un nuovo volto	
– Umfrage der Forschungskommission ✓		– Sondage de la commission de recherche		– Sondaggio della Commissione di ricerca	
Dialog		Dialogue		Dialogo	
– Méthode Mézières		– Méthode Mézières		– Méthode Mézières	
– Herzlich willkommen beim SPV!		– Soyés les bienvenus à la FSP!		– Il nostro più cordiale saluto ai nuovi membri della FSF!	
32				38	
BDF ●●●●		Kurznachrichten / Nouvelles / Notizie in breve		42	
Beiersdorf		Kurse / Tableau des cours / Corsi		46	
medical		Stellenanzeiger / Service d'emploi / Annunci di lavoro		68	
4142 Münchenstein		Impressum / Impressum / Impressum		88	
					




# ITO PHYSIO-THERAPY & REHABILITATION

## SW-180

ITO JAPAN proudly presents  
the renowned  
shortwave therapy unit "SW-180".

New in  
Europe  
!!

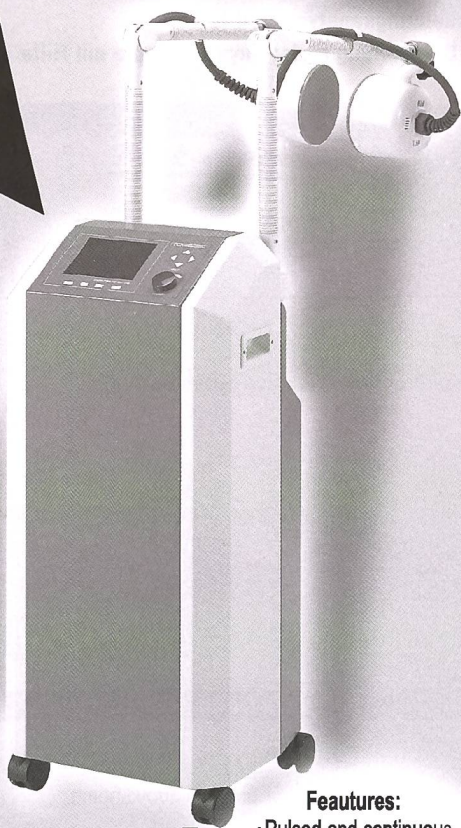

**Advanced  
medical  
technology  
for physiotherapy  
equipment.**

### Features:

- Pulsed and continuous
- Automatic tuning
- Previous treatment memory
- 28 programmable treatment memories
- Extensive range of parameters
- Various applicator options
- Low interference levels



**ITO CO., LTD.**

3-3-3, TOYOTAMA-MINAMI, NERIMA-KU, TOKYO  
176-8605, JAPAN

TEL: 81-3-3994-4619 • FAX: 81-3-3994-1465

E-mail: itocoltd@itolator.co.jp • <http://www.itolator.co.jp>

# DELTA MED-ERBE

## SONOTUR 430

das handliche und tragbare Gerät für  
die effiziente **Ultraschall-Therapie** im  
ambulanten und klinischen Bereich



modern, sicher, preiswert  
Verlangen Sie eine Probestellung


DELTA MED-ERBE AG

Fröschenweidstrasse 10, 8404 Winterthur

Tel. 052 233 37 27, Fax 052 233 33 01, E-Mail: [info@deltamed.ch](mailto:info@deltamed.ch)

## BEHANDLUNGSTISCHE

Das unübertroffene Original  
aus USA

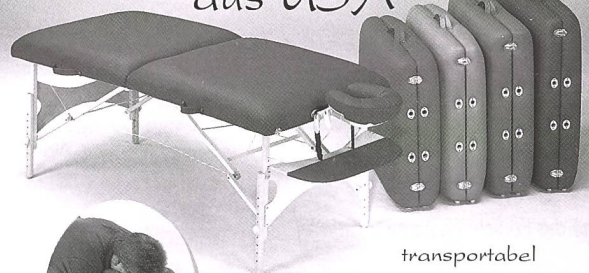

ideale Entlastung  
in Bauchlage



elektrisch höhenverstellbar

Sitzmassage  
Portal Pro



Kataloge anfordern oder  
Besichtigungstermin vereinbaren

**OAKWORKS** - G. Dawson

Berninastr. 11

CH - 8057 Zürich

Tel. 01 - 312 26 07

Fax 01 - 312 27 20

**BESUCHSZEITEN** (bitte nur nach Voranmeldung)

Mo & Di & Fr & Sa 9 - 18 Uhr (Mi + Do geschlossen)



PRAXISZUBEHÖR